


LABORATORIO DE GENOTOXICIDAD

Responsable: Dra. Ma. Luisa Ramos Ibarra

EQUIPOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS:

- Incubadoras.
- Balanzas Analíticas.
- Centrífugas.
- Stomacher y homogenizadores.
- Microscopios de campo claro.
- Incubadora con agitación.
- Campana de flujo laminar nivel I y II.
- Baños de agua.
- Horno para esterilización seca.
- Bioscreen.
- Chiller (enfriador para baños maría).
- Refrigeradores, vitrinas y congeladores de -20°C.
- Placas de agitación y calentamiento.
- Cuenta colonias.
- Vortex.
- Bomba de vacío.
- Ollas para esterilización húmeda.

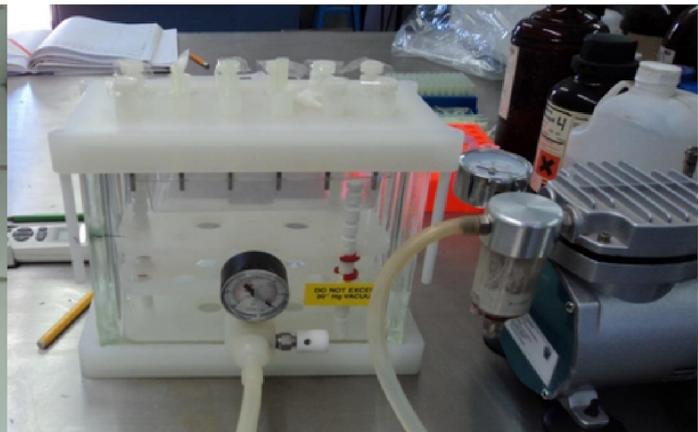



Lab. Toxicología Genética, Departamento de salud pública, CUCBA.



Lab. Toxicología Genética, Departamento de salud pública, CUCBA.




Lab. Toxicología Genética, Departamento de salud pública, CUCBA.




Lab. Toxicología Genética, Departamento de salud pública, CUCBA.



Lab. Toxicología Genética, Departamento de salud pública, CUCBA.

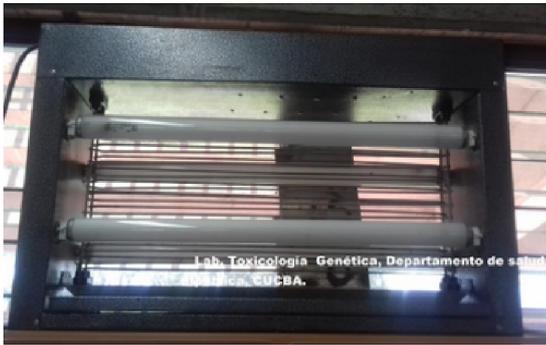

Lab. Toxicología Genética, Departamento de salud pública, CUCBA.

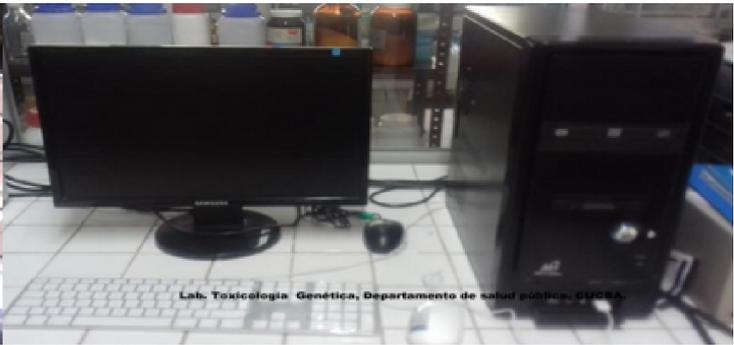

Lab. Toxicología Genética, Departamento de salud pública, CUCBA.



Lab. Toxicología Genética, Departamento de salud pública, CUCBA.



Lab. Toxicología Genética, Departamento de salud pública, CUCBA.



Lab. Toxicología Genética, Departamento de salud pública, CUCBA.